

## Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /17

Data: 13.06.2017 r.

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów higienicznych, obłóżek, pół operacyjnych, serwet i odzieży medycznej już na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. (Znak postępowania: 2728/2017).**

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

### Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu uniwersalnego ?


- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Gramatura 60 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej.

Gramatura łaty chłonnej 80 g/m<sup>2</sup>.

Spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.


**Odpowiedz: Nie**

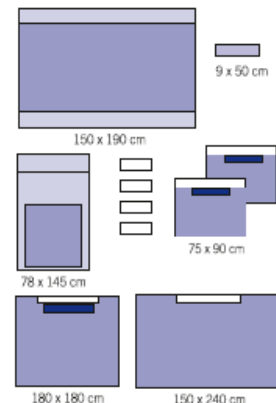

### Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu uniwersalnego?

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 25x60 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm) z dodatkową łatą chłonną 25x60 cm

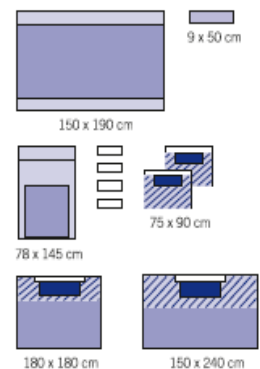

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Gramatura 75 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej.

Gramatura łąty chłonnej 80 g/m<sup>2</sup>.

Spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

**Odpowiedz: Nie**

### Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu 2 poz. 2


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu do cięcia cesarskiego?

- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 1 taśma przyklepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torebką na płyny 72x72cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Gramatura 60 g/m<sup>2</sup>

Spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

**Odpowiedz: Nie**

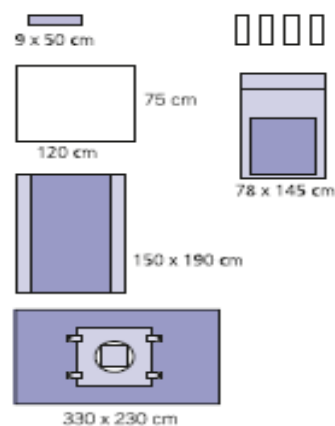

### Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu do artroskopii stawu kolanowego?


- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 1 taśma mocująca 9x50cm
- 1 osłona foliowa na przewody 15 x 240 cm, z przyklepcami, perforowana końcówka
- 1 osłona na nogę 36 x 65 cm wykonana z kratonu
- 1 serweta do artroskopii 230 x 300 cm przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni), z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 140 x 150 cm

Gramatura 60 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej.

Gramatura łąty chłonnej 80 g/m<sup>2</sup>.

Spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.


**Odpowiedz: Nie**

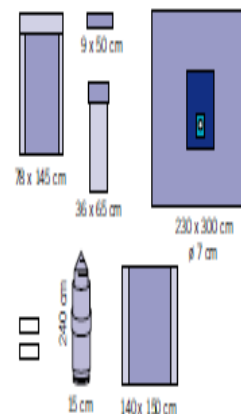

### Pytanie nr 5 - dotyczy Pakietu 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu do chirurgii odybytnicy?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 taśmy przyklepne 9 x 50 cm
- 1 serweta brzuszno-kroczoowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przyklepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)

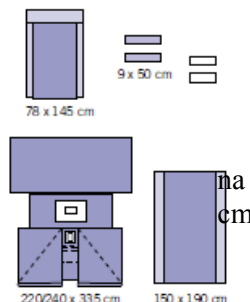

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Gramatura 60 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej.


Spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

**Odpowiedz: Nie**

#### Pytanie nr 6 - dotyczy Pakietu 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu do chirurgii odbytynicy?

1. serweta na stolik do instrumentarium 150 x 190 cm
2. serweta brzuszno-kroczoowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)
3. serweta na stolik Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85 cm), składana teleskopowo
4. Serweta przylepna 50 x 60 cm
5. 2 ręczniki do rąk
6. przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm
7. taśma mocująca 9 x 50 cm

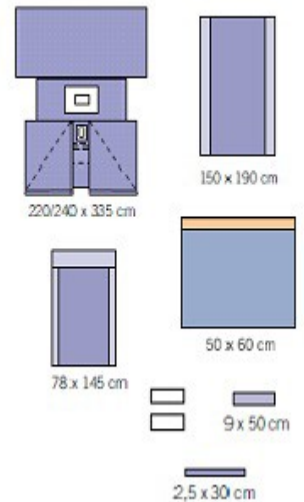

**Odpowiedz: Nie**

#### Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 1 poz.3 czepka z gumką z tyłu?

**Odpowiedz: Nie**

#### Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 1 poz.3 czepka głębokiego z możliwością wywinięcia, które będzie stanowiło dodatkową warstwę chłonną?

**Odpowiedz: Dopuszcza, ale pozostałe parametry winne być zgodne z SIWZ**

#### Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 1 poz.4 czepka pakowanego w torebki foliowe po 50szt?

**Odpowiedz: Nie**

#### Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 1 poz.3 i 4 do osobnego zadania co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?

**Odpowiedz: Nie**

#### Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie nr 12 - Pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną z włókniny, z gumką, zieloną, z wkładką modelującą na nos z miękką wyściółką, pakowaną w kartonik a'50 szt. o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie nr 13 - Pakiet 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną z włókniny, na troki, zieloną, z wkładką modelującą na nos z miękką wyściółką, pakowaną w kartonik a'50 szt. o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie nr 14 - Pakiet 1 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie nr 15 - Pakiet 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści czepkę typu furazerka, włókninowy, z warstwą przeciwpotną w przedniej części czepka, gramatura 25g/m<sup>2</sup>, pakowany pot 100 szt. w opakowanie foliowe?

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie nr 16 - Pakiet 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści czepkę typu beret, włókninowy, gramatura 25g/m<sup>2</sup>, pakowany po 100 szt. w opakowanie foliowe?

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie nr 17 - Pakiet 1 poz. 3-4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie nr 18 - Pakiet 1 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy, gramatura 20g/m<sup>2</sup>, rozmiar uniwersalny, wykończony mankietami, wiązany na troki?

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie nr 19 -Pakiet 2 – Obłożenie pola operacyjnego, poz. 1. zestaw uniwersalny:**

- czy zamawiający dopuści wykonanie serwet z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, przy zachowaniu parametrów medycznych

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie nr 20 -poz. 2. zestaw do cięcia cesarskiego:**

- czy zamawiający dopuści wykonanie serwet z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, przy zachowaniu parametrów medycznych

- czy zamawiający dopuści rozmiar serwety dla noworodka o wymiarach minimum 70x80 cm

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie nr 21 -poz. 3. zestaw do artroskopii:**

- czy zamawiający dopuści wykonanie serwet z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, przy zachowaniu parametrów medycznych

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie nr 22 -poz. 4. zestaw do chirurgii odbytnicy**

- czy zamawiający dopuści rozmiar taśmy samoprzylepnej 10x50 cm

**Odpowiedz: Dopuszcza, jeśli pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.**

**Pytanie nr 23 - pakiet 3 - Serwety sterylne poz. 1-3**

Czy zamawiający dopuści wykonanie serwet z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, przy zachowaniu parametrów medycznych

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie nr 24 - pakiet 3 - Serwety sterylne poz.2**

Prosimy o określenie przez zamawiającego minimalnej wielkości otworu.

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie nr 25 - dotyczy: Specyfikacja przetargowa:**

- prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zamawiający definiuje terminy dostawy towaru:  
czy określenie: " termin do 1 dnia roboczego" oznacza dostawę towaru:

a.) w dniu złożenia zamówienia,

b.) dostawę na następny dzień roboczy?

**Odpowiedz: Oznacza dostawę towaru na następny dzień roboczy.**

- czy w przypadku

b) zamawiający jest w stanie składać zamówienia najpóźniej do godz. 10.00, jeżeli towar miałby być wysłany tego samego dnia?

**Odpowiedz: Jeśli Zamawiający nie złoży zamówienia do godziny 10:00, towar Dostawca wysyła na następny dzień roboczy.**